


体組成計

取扱説明書

保証書付

BC-UN シリーズ

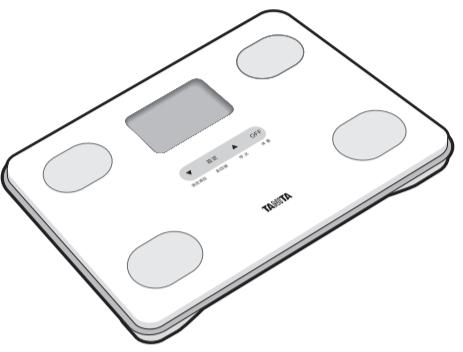

本書に記載されているイラストはイメージ図です。

このたびは、体組成計をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
毎日の健康管理にお役立てください。

お願い

誤った使い方をしますと重大な事故につながります。

本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

また必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

保証書

販売店様へ
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触ることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理いたします。

品 名	体組成計 BC-UN		
保 証 期 間	お買い上げ日より1年		
お 買 上 げ 日	年	月	日
お 客 様	住所	お名前 様	
	電話 ()		
販 売 店	住所・店名	(印)	
	電話 ()		



経済産業省令

適合マーク

輸入元 株式会社 **TANITA**
本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

フリーダイヤル **0120-133821**
携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。
ナビダイヤル **0570-783551**
電話料金はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00~18:00(祝日を除く月~金)
タニタサービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市見内字下田茂木添2B-1

1. 安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。



この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容を示しています。



この表示の欄は「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容を示しています。



してはいけない「禁止」内容を示しています。



「必ず守っていただき」内容を示しています。

警告

ベースメーカーなど、体内機器装着者は絶対に使用しない

本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器の誤動作による重大な事故につながるおそれがあります。

測定結果は、決して自己判断しない

(測定値の評価、それに基づく運動メニューなど)

自己判断による減量や運動療法は健康を害するおそれがあります。
必ず資格を持った専門家の指示に従ってください。

本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない

転倒したり、すべったりして大けがをするおそれがあります。

タイル面や濡れた床など、すべりやすい所では使用しない

転倒したり、すべったりして大けがをするおそれがあります。また、本機内部に水が浸入し故障するおそれがあります。

物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃をあたえない

ガラスが破損し、けがをするおそれがあります。

注意

表示部や操作部の上に乗らない

破損してけがをするおそれがあります。

隙間や穴に指を入れない

けがをするおそれがあります。

充電式の電池を使用しない

公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本機の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障のおそれがあります。必ず指定の電池を使用してください。

新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない

液漏れや発熱、破裂により、本機の故障やけがをするおそれがあります。

乳幼児には、絶対に持ち運びさせない

落として、けがをするおそれがあります。

業務用（病院などで測定）には、絶対に使用しない

業務用として病院などで使用するための機能を備えておりませんので、病院などでは絶対に使用しないでください。

熱湯やベンジン、シンナーなどは、使用しない

汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し、**固く絞って**拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

分解や水洗いは絶対にしない

本機の損傷や故障のおそれがあります。

過度の衝撃や振動を与えない

本機の損傷や故障のおそれがあります。

以下の場所で保管や使用をしない

本機の損傷や故障のおそれがあります。

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる場所
- 温度変化の激しい場所
- 湿気の多い場所や水気のある場所
- 振動の激しい場所

体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない

介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。（※手すりなどを利用した場合、測定値は参考値として捉えてください。）

電池を入れるときは、極性（+、-）の方向を間違わない

液漏れなどで、床などを汚損するおそれがあります。（長期間ご使用にならない場合は、電池を本機から取り外してください。）

濡れた体で乗らない

体や足の水分を**よく拭いてから**測定してください。転倒してけがをするおそれがあります。また、正確な測定できません。

操作部を濡らしたり汚したりしない

ボタンが反応しなかったり、誤作動のおそれがあります。

携帯電話や電子レンジなど電波を発する機器を本機の近くで使用しない


誤作動して正確に測定できないおそれがあります。

2. 正しいはかりかた

測定場所

硬く、平らな安定した場所でご使用ください。

- じゅうたんや、畳の上で使用しない。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる場所で使用しない。
- 温度変化の激しい場所で使用しない。
- 湿気の多い場所や水気のある場所で使用しない。
- ・クロク床やクッションフロアなどの軟らかい床でご使用になると、精度の保証ができません。
- また、ご使用になる場所によっては、凹みなどの跡が残るおそれがありますので、ご使用される場所の方などでご確認ください。



保管場所

以下のような場所で保管しないでください。


また、立てかけたり、本機に物を置いた状態で放置しないでください。
正常に機能しないおそれがあります。

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる場所
- 温気の多い場所や水気のある場所
- 振動の激しい場所




MEMO 「0リセット」について

- 本機は、乗るだけで電源が入り測定を開始します。そのため、電源が切れているときに、本機は自動で定期的に「0」にリセットされています（0リセット）。本機を立てかけたり、本機の上に物を置いた状態で保管すると、「0リセット」が正しく行われません。

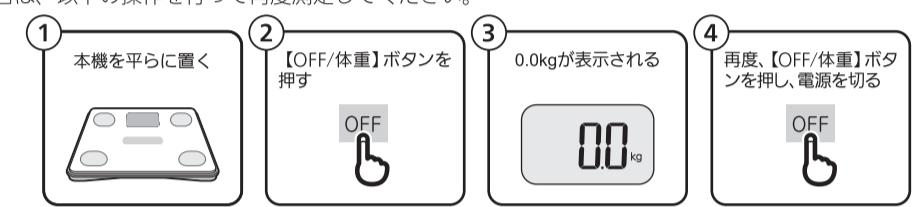

測定時間・条件

生活パターンの違いにより体重やからだの電気抵抗が変動するため、測定値には個人ごとに違った変動があります。さらに、測定値は体内水分の変化や体温に大きく影響されるので、できるだけ同じ時間帯、同じ状態で測定し、細かい変化にとらわれず、長期的な変化傾向を見ることをおおすすめします。

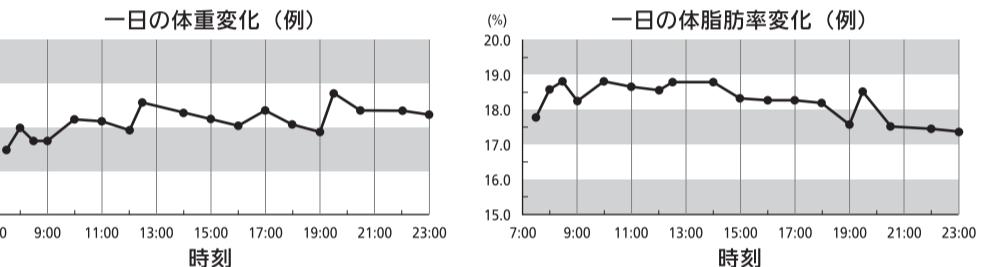

■ おすすめ測定時間



過度の飲食、極度の脱水症状のときは、測定を避ける

測定値に誤差が生じるおそれがあります。精度を高めるには、起床直後を避け、食後2時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。

サウナや半身浴（長湯）、激しい運動をした後は、測定を避ける

測定値に誤差が生じるおそれがあります。十分休んでから、測定してください。

体調の悪い場合（二日酔い、下痢、発熱などのとき）は、測定を避ける

測定値に誤差が生じるおそれがあります。十分休んでから、測定してください。

必ず守る

過度の飲食、極度の脱水症状のときは、測定を避ける

測定値に誤差が生じるおそれがあります。精度を高めるには、起床直後を避け、食後2時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。

サウナや半身浴（長湯）、激しい運動をした後は、測定を避ける

測定値に誤差が生じるおそれがあります。十分休んでから、測定してください。

体調の悪い場合（二日酔い、下痢、発熱などのとき）は、測定を避ける

測定値に誤差が生じるおそれがあります。十分休んでから、測定してください。

必ず守る

なるべく裸に近い状態で測定する

着衣のまま測定すると、着衣の重さが含まれます。

足の裏を、電極部に正しく合わせて測定する

電極と足の裏が接触不良の場合、体脂肪率が低く表示されたり、「Err」（エラー）が表示される場合があります。

素足になり、足の裏の汚れを落としてから測定する

靴下などを履いていたり、足の裏にはこりなどがついていると、正確に測定できません。

ヒザを曲げたり、座ったまま測定しない

正確に測定できません。

測定中は動かない

測定中に動くと、正確に測定できません。

足の内側（内もも）がつかないないように測定する

内ももがついてしまう場合は、乾いたタオルなどをはさんで測定してください。

MEMO

以下に当てはまる方は、参考値として変化の推移をみられることがあります。

- ・ボディビルダー、力士、スポーツを職業とされている方、およびそれに近い方
- ・体内に金属を装着されている方
- ・体水分の変化を誘発する薬（例：利尿剤など）を服用されている方
- ・妊娠中や、人工透析患者、またはむくみ症状の方

※ 本機は、日本人の一般男女および小学生以上の子供を対象にしているため、上記のような方は、体脂肪率の信頼性が低下するおそれがあります。

- ・かかとの表面（角質層）が固い状態の方は、正常な測定ができません。

足の裏をしめらせてから測定してください。

MEMO


操作を中断したまま、約60秒経過すると、電源が自動で切れます（オートパワーオフ機能）。

・設定を中止したい場合は、OFFボタンを押してください。途中で中止した場合は、地域は保存されません。


3. 各部の名称／付属品

各部の名称


● 表面

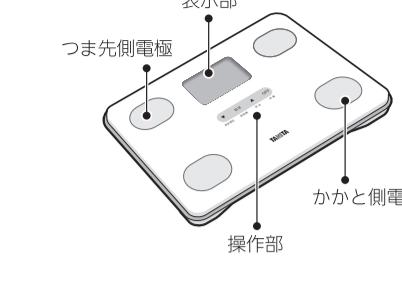

● 裏面

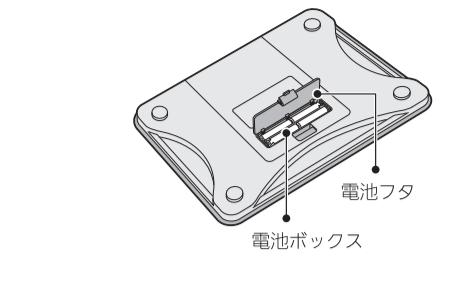

● 操作部 ※ 指の腹でしっかりと触れてください。

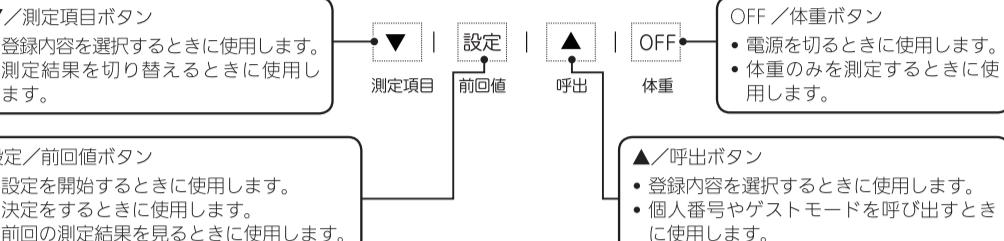

6. 個人データを登録する

測定する前に、個人データの登録が必要です。個人データは5人まで登録することができます。

1 電源が入っていないことを確認し、設定ボタンを押します。

2 登録する番号を決めます。

▼ボタンまたは▲ボタンを押して登録する番号（1～5）を選択し、設定ボタンを押して決定します。

点滅している番号は、未登録の状態です。

点灯している番号には、すでに個人データが登録されています。

3 年齢を登録します。

▼ボタンまたは▲ボタンを押して年齢を選択し、設定ボタンを押して決定します。

MEMO

- 年齢は6～99才の範囲で登録できます。

- 登録した年齢は自動で更新されません。誕生日ごとに年齢を更新してください。（☞「11. 個人データを変更／消去する」）

- ▼ボタンまたは▲ボタンを長押しすると、数値が早送りされます。

4 性別を登録します。

▼ボタンまたは▲ボタンを押して性別（「女」または「男」）を選択し、設定ボタンを押して決定します。

5 身長を登録します。

▼ボタンまたは▲ボタンを押して身長を選択し、設定ボタンを押して決定します。

MEMO

- 身長は90.0～220.0cmの範囲で登録できます。

- ▼ボタンまたは▲ボタンを長押しすると、数値が早送りされます。

6 「0.0kg」が表示されたら、素足で正しく乗ります。

※必ず本機に乗って測定してください。

測定しないと個人データは登録されません。

※「0000」が消えるまで本機から降りないでください。



・正しいはかりかたについては、「2. 正しいはかりかた」をご覧ください。

登録した個人データ（番号、年齢、性別、身長）が表示されたら、本機から降ります。

女 - 3 -

女 37 才

159.5 cm

測定結果が順番に表示された後、もう一度体重を表示し、約40秒後に自動で電源が切れます。
以上で個人データの登録は終了です。



・「000kg」が表示される前に本機に乗ると、「Err」または「-OL」が表示されたり、測定途中で電源が切れたりします。

・操作を中断したまま、約60秒経過すると、電源が自動で切れます（オートパワーオフ機能）。その場合登録されません。

・登録を中止したい場合は、OFFボタンを押してください。途中で中止した場合は、個人データは保存されません。

7. 乗るピタ機能で測定する

乗るピタ（自動認識）機能は、ご使用前に個人データの登録が必要です。

乗るピタ機能とは、登録者の中から測定者を認識し、測定から結果表示までを自動で行う機能です。ご使用の前に個人データを登録しておくと、体重や体の電気抵抗値をもとに誰が測定しているかを認識します。



1 電源が入っていないことを確認し、素足になり、本機に正しい姿勢で乗ります。

自動で電源が入り、体組成を測定して登録内容と照合します。

→測定中は、動かないようにしてください。



・正しいはかりかたについては、「2. 正しいはかりかた」をご覧ください。

2 個人データが表示されたら、本機から降ります。

認識された個人データが表示されたあと、測定結果が表示されます。



測定後、降りてから約3秒間は、本機を動かさないでください。

転倒防止のため、必ず本機から降りて操作してください。

測定結果が順番に表示されたあと、もう一度体重が表示されて、約40秒後に自動で電源が切れます。

→測定結果を表示中に▼測定項目ボタンを押すと、項目を手動で切り替えることができます。

1. 体重
52.9 kg

2. BMI
21.0

3. 体脂肪率
28.3 %

4. 内臓脂肪レベル
45 レベル


・体脂肪率の測定範囲を超えると「Err %」（エラー）が表示されます。

・17才以下の場合は、「体重」、「BMI」、「体脂肪率」のみが表示されます。



■誤認識だった場合

体重や体の電気抵抗値が似た人が複数登録している場合や、体重に大きな変動があった場合などは、乗るピタ機能が正常に機能せず、誤認識をすることがあります。その際は以下の操作を行ってください。

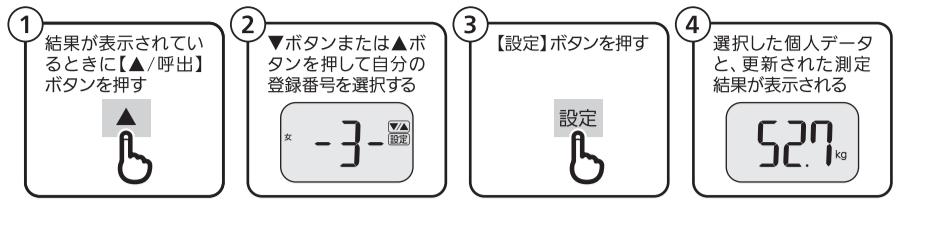

MEMO

・誤認識が続く場合は、登録番号を指定して測定してください。（☞「8. 登録番号を指定して測定する」）

8. 登録番号を指定して測定する／ゲストモードで測定する

登録番号で測定する場合、あらかじめ個人データの登録が必要です。（☞「6. 個人データを登録する」）

1 電源が入っていないことを確認し、▲／呼出ボタンを押します。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して、自分の個人番号を選択し、設定ボタンを押します。

11. 個人データを変更／消去する

1 電源が入っていないことを確認し、設定ボタンを押します。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して変更（消去）したい登録番号を選択します。



変更する場合は手順3へお進みください。
消去する場合は手順6へお進みください。

<変更する>

3 設定ボタンを押します。

4 「6. 個人データを登録する」に従って、個人データを変更します。

■年齢を上げる、または身長を変更した場合

※この場合、前回値は消去されません。
身長登録後、登録内容が表示され電源が自動で切れます。

これで個人データの変更は終了です。

■年齢を下げる、または性別を変更した場合

※この場合、前回値は消去されます。

「Err」（クリア）が表示されます。手順5にお進みください。



5 個人データを上書きしたい場合は▼ボタンまたは▲ボタンで「YES」（イエス）を選択し、設定ボタンを押します。

登録内容が表示された後、電源が自動で切れます。

以上で個人データの変更是終了です。

MEMO

「NO」（ノー）を選択すると、「NO」（ノー）が点灯し、電源が自動で切れます。
個人データは変更されません。

<消去する>

6 設定ボタンを4秒以上長押しします。

個人データが表示されたあと、「Err」（クリア）が表示されます。

7 ▼ボタンまたは▲ボタン押して「YES」（イエス）を選択し、設定ボタンを押します。

「YES」（イエス）点灯後、「---」が順に点灯し、電源が自動で切れます。

以上で個人データの消去は終了です。

MEMO

「NO」（ノー）を選択すると、「NO」（ノー）が点灯し、電源が自動で切れます。
個人データは消去されません。

MEMO

・操作を中断したまま、約60秒経過すると、電源が自動で切れます（オートパワーオフ機能）。

・登録を中止したいときは、OFFボタンを押してください。途中で中止した場合は、個人データは保存されません。

9. 前回値を見る

前回値ボタンを使うと、各項目の前回の測定結果を見るることができます。

■測定終了後に前回値を確認したい場合

・測定終了後、本機を降りてから、測定結果が表示されている間に設定／前回値ボタンを押すと、表示している項目の前回の測定結果が表示されます。



このとき▼測定項目ボタンを押すと、別の項目の前回値を表示します。

もう一度設定／前回値ボタンを押すと、今回の測定結果に戻ります。

ご注意

転倒防止のため、必ず本機から降りて操作してください。

■測定せずに前回値を見たい場合

1 電源が入っていないことを確認し、▲／呼出ボタンを押します。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して、自分の登録番号を選択し、設定ボタンを押します。

3 「00kg」が表示されたら、設定／前回値ボタンを押します。

前回の測定結果が順に表示されます。

▼測定項目ボタンを押すと、別の項目の前回値を表示します。

この操作は前回値ボタンを押すと、別の項目の前回値を表示します。

もう一度設定／前回値ボタンを押すと、今回の測定結果に戻ります。

この操作は前回値ボタンを押すと、別の項目の前回値を表示します。